
Eau déminéralisée ne veut pas dire eau de qualité 1.


Trois qualités, trois conductivités, trois usages.

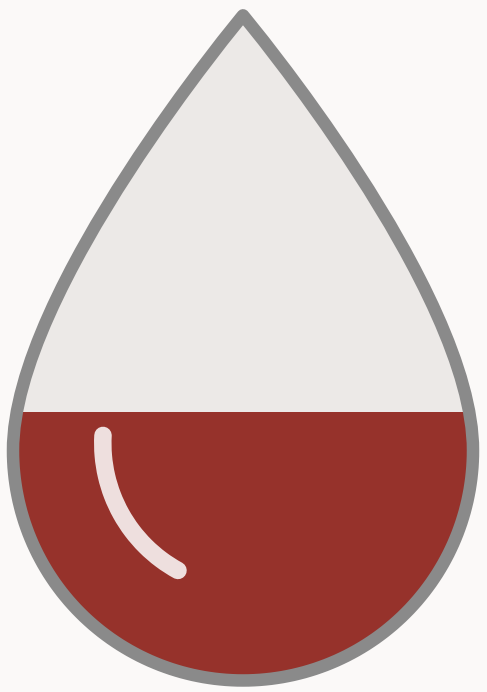

QUALITÉ

ISO 3696

1

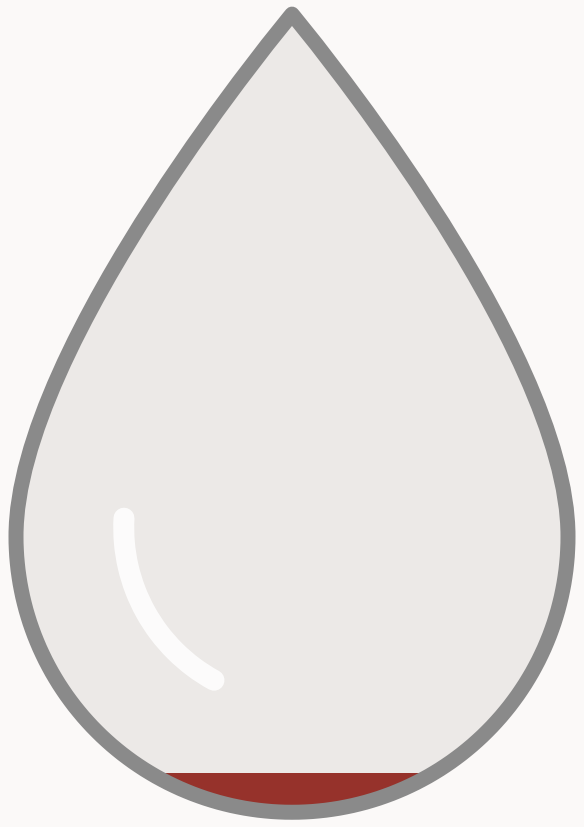

Conductivité maximale à 25 °C

0,1 µS/cm

soit 0,01 mS/m

Usage

HPLC


18,2 MΩ·cm correspond à la qualité 1.

Eau de laboratoire **2/5**

QUALITÉ

ISO 3696

2

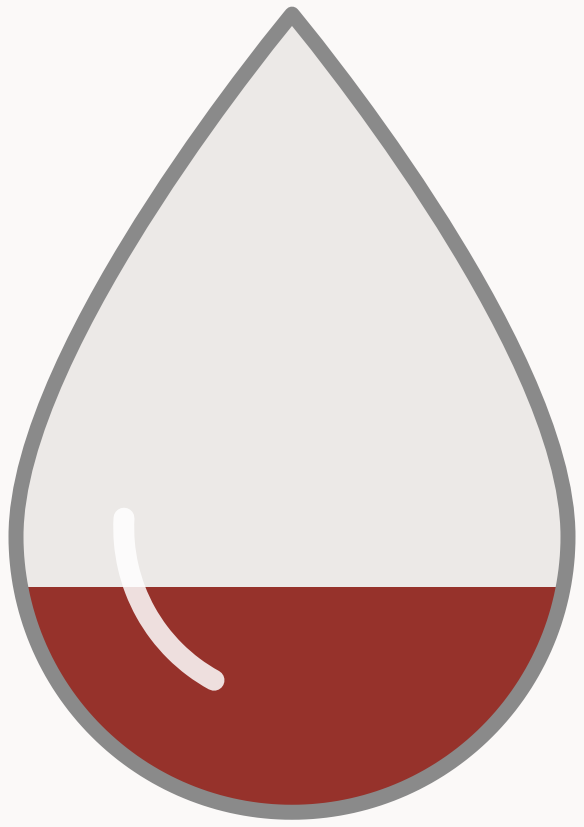

Conductivité maximale à 25 °C

1 µS/cm

soit 0,1 mS/m

Usage


Absorption atomique et traces

Eau de laboratoire **3/5**

QUALITÉ

ISO 3696

3

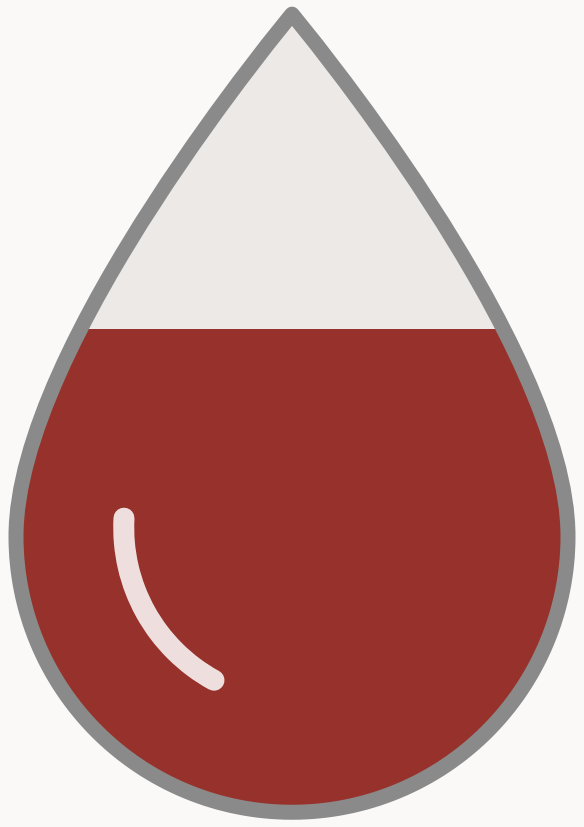

Conductivité maximale à 25 °C

5 µS/cm


soit 0,5 mS/m

Usage

Chimie courante et préparation de réactifs

Eau de laboratoire

Qualités 1 et 2 :

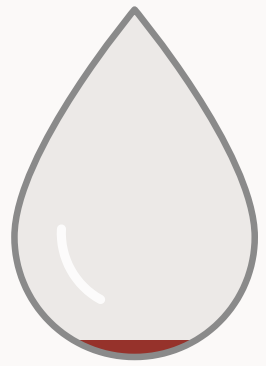

on ne les stocke pas.

À utiliser fraîchement préparées : le CO_2 de l'air fait remonter la conductivité.

MIMÉLEC

The Good Sciences